




MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"
SAN VICENTE



VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"

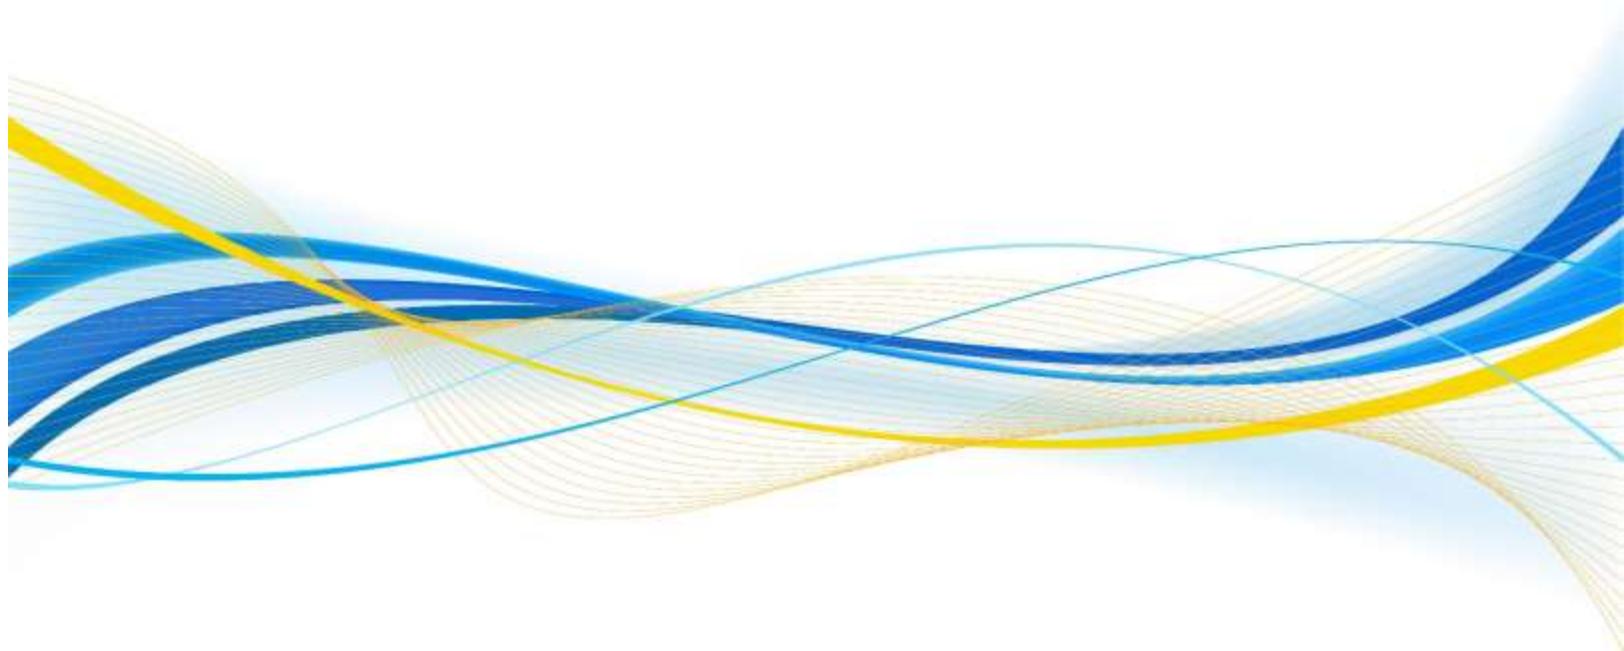

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Vicente 25 de Abril del 2016	No.Orden:055/2016
----------------	---	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	81201023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO. (PARA EQUIPO MARCA: TUTTNAUER; MODELO: 6990 SP-2A; SERIE: 2810017; EQUIPO #1. INSTALADO EN CENTRAL DE ESTERELIZACIÓN, DEBE INCLUIR: 4 BOBINAS 24VDC PARA VALVULA SOLENOIDE, 2 MANOMETROS INDICADOR DE PRESIÓN DE SELLADO PUERTA, 4 VALVULAS SOLENOIDE, 4 CONECTORES DE MANGUERA PARA AIRE, 10 ROLLOS DE PAPEL TERMICO, 2 ACTUADORES NEUMÁTICOS PARA APERTURA/CIERRE DE LAS PUERTAS, 25 METROS DE MANGUERA PARA AIRE, 4 VALVULAS DE SEGURIDAD PARA VAPOR, 2 FILTROS DE AIRE TIPO HEPA DE 0.01 MICRON, 4 EMPAQUES DE PUERTA PARA 69 XX SERIES. OFRECEN: 81201023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR (CALOR HUMEDO) MARCA: TUTTNAUER MODELO 6990SP-2A, SERIE: 2810017 EQUIPO #1 INSTALADO EN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EL CUAL INCLUYE: 4 BOBINAS 24VDC PARA VALVULA. 2 MANOMETRO INDICADOR DE PRESIÓN DE SELLADO DE PUERTA. 4 VALVULAS SOLENOIDE. 4 CONECTORES DE MANGUERA PARA AIRE. 10 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESIÓN DE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN. 2 ACTUADORES NEUMÁTICOS PARA APERTURA/CIERRE E LAS PUERTAS. 25 METROS DE MANGUERA PARA AIRE. 4 VALVULAS DE SEGURIDAD PARA VAPOR. 2 FILTROS DE AIRE TIPO HEPA DE 0.01 MICRON. 4 EMPAQUES DE PUERTA PARA 69XX SERIES. PRECIOS INCLUYEN IVA. ORIGEN: ISRAEL/USA/N/A, VENCIMIENTO: N/A. MARCA: UTTNAUER/ASHCROFT/N/A, VALIDEZ DE LA OFERTA(PLAZO) 15 DÍAS, FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS, PLAZO DE ENTREGA: DE 15 A 45 DÍAS HÁBILES EN LOS REPUESTOS ORIGINALES DE TUTTNAUER, TODO RECIBIDO EN REPORTE DE SERVICIO O ACTA DE RECEPCIÓN, GARANTIA: INCLUYE LOS REPUESTOS OFERTADOS EN 30 DÍAS CALENDARIO	\$7,650.00	\$7,650.00
-	-	TOTAL.....	-	\$7,650.00

SON: siete mil seiscientos cincuenta 00/100 dólares
OBSERVACION:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El contratista deberá entregar en la Unidad Financiera el acta y factura para completar el proceso, de lo contrario se tendrá por incumplida la entrega. ✓ DEPENDENCIA SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

- ✓ UNIDAD RESPONSABLE DE RECIBIR EL BIEN O SERVICIO: **MANTENIMIENTO**
- ✓ No. SOLICITUD DE COTIZACION Y PROCESO DE COMPRA **No. 041/2016**
- ✓ **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO. (PARA EQUIPO MARCA: TUTTNAUER; MODELO: 6990 SP-2A; SERIE: 2810017”.**
- ✓ ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SEGÚN ACUERDO No.39. **Será el Sr. Saúl Erasmo Manzanares Martínez** Técnico en Mantenimiento II
- ✓ Teléfono: 2393-9500. extensión : 2540, 2618, 2611


NOMBRE: “MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO.”PARAMEDICOS DE EL SALVADOR

LUGAR DE ENTREGA: EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS UBICADO EN LA 8°. Avenida Sur No.1000 Barrio San Francisco San Vicente - Favor de emitir factura Consumidor Final a nombre de Hospital Nacional “Santa Gertrudis”, San Vicente “NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1% NIT: 1010-110222-001-6 - EL HORARIO PARA LA RECEPCION DE PRODUCTOS ES DE 7:30 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 a 2:00 p.m. **NOTA:** Por motivo de cierre contable, no se recibirá suministro o servicio, y dará trámite a facturas y documentos de pago los últimos tres días de cada mes. La cancelación se efectuara en la División de Tesorería de la Unidad Financiera Institucional del HOSPITAL.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: **“MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO.” PARAMEDICOS DE EL SALVADOR.** Prolongación Calle Arce Edificio 3020 Entre 57 y 59 Av. Norte San Salvador. Teléfono: 2124-6872, 2124-6873 Fax: 2208-4973. E-mail: gerencia@paramedicos.com.sv

----- Titular o Designado	-----
-----	----- Suministrante

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Vicente 25 de Abril del 2016		No.Orden:055/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0101 Dirección Superior y Administración- FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	81201023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO (PARA EQUIPO MARCA: TUTTNAUER; MODELO:6990 SP-2A; SERIE: 2810017; EQUIPO #1. INSTALADO EN CENTRA DE ESTERELIZACION, DEBE INCLUIR: 4 BOBINAS 24VDC	\$7,650.00	\$7,650.00
-	-	TOTAL.....	-	\$7,650.00
SON: siete mil seiscientos cincuenta 05/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA: EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS SAN VICENTE.				
 Titular o Designado				
		Suministrante		

Elaborado por: FSALDAS