




MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"
SAN VICENTE



VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"

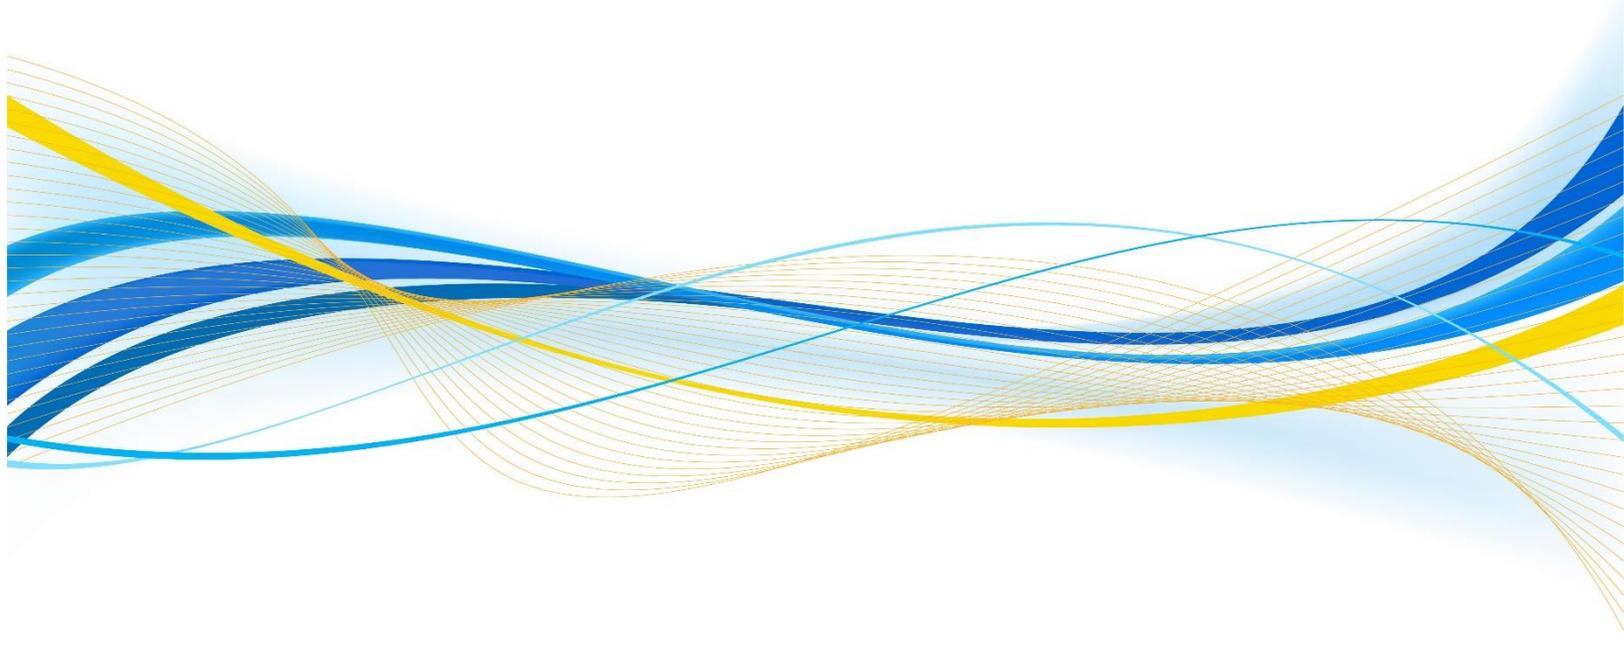

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Vicente 25 de Octubre del 2016		No.Orden:150/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
MULTI INVERSIONES DIAZ SALVADOREÑAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FONDOS PROPIOS	-	-
1	Cada Uno	<p>60303760 MONITOR MATERNO FETAL SENCILLO (Transductor de Frecuencia, Tocodinamómetro y Transductor de Eventos). Ofrecen: MONITOR MATERNO FETAL SENCILLO MARCA: GENERAL MEDITECH INC. MODELO: G6A Plus. ORIGEN: CHINA. ESPECIFICACIONES: Monitor materno fetal, tipo portátil. Características: Visualización: pantalla de 10.4"del color TFT LCD, presenta onda y datos del monitor. Vigilar la forma de onda de FHR (ritmo cardiaco fetal), de TOCO, de FM (movimiento fetal) y de FM. El color de los parámetros y de las formas de onda se establece según la preferencia del usuario.</p> <p>Por lo menos 24 horas de almacenaje de datos. Revisión seleccionable e impresión después de la potencia de apagado, impresión de alta velocidad 25mm/s de los datos salvados de CTG. Imprimir-velocidad seleccionable: 1cm/mm\2cm/mm\3cm/min\ 25mm/sec Alarmas visibles. Especificaciones: FHR (ritmo cardiaco de Fetal), Frecuencia del Ultrasonido: 1MHz± 1KHz, Rango de la Medida: 30~240bpm, Resolución: ±1bpm, Alarma y Exactitud: De límite superior: bpm (de 30~240), ± el 5%. TOCO: Rango: el 0~100%, Resolución: el 1%, Cero-Modo: Manual 5,10,15, línea de fondo de TOCO ajustable, Exactitud de la medida de la Presión: +6.7%, Movimiento Fetal: Marca manual y auto dl movimiento fetal, Forma de onda auto del movimiento fetal, Ancho-línea impresora, Papel de la Impresora: Z-tipo plegable papel termal, Anchura: 110mm, Velocidad de Impresión: 1cm/min,2cm/min,3cm/min e intermediario de 25cm/sec. ACCESORIOS INCLUIDOS: 10 Resmas de Papel. <u>CONDICIONES GENERALES:</u> Precio: Incluye IVA, Lugar de Entrega: Almacén del Hospital, <u>Tiempo de Entrega: 30 días hábiles</u></p>	\$1,962.03	\$1,962.03

		después de recibir la Orden de Compra, Vigencia de la Oferta: 30 días, Crédito 60 días, Garantía: un año por desperfectos de fábrica comprobados no así por golpes o mal uso.		
-	-	TOTAL.....	-	\$1,962.03

SON: **mil novecientos sesenta y dos 03/100 dólares**

OBSERVACION: SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CON FECHA 07 DE SEP. DE 2016, EL HOSPITAL ES AGENTE DE RETENCION DEL 1% DEL IVA **ADMINISTRADOR DE CONTRATO**. Para la Administración de la presente Orden de Compra el Hospital delega a la **Licda. Milagro del Carmen Castillo Ruiz de Zúniga**, quien será la responsable de la ejecución de la presente Orden de Compra. Así mismo será el enlace entre el contratista y el contratante. Administración que se hará de conformidad al Artículo 82 Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, Manuales e Instructivos de la UNAC.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL DEPARTAMENTO DEL ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS. Las horas de entregas son desde las 07 horas 30 minutos a las 12:00 horas y de las 13:00 horas a las 14 horas 30 minutos.

Orden de Compra Realizada según Proceso de compra **No. 109/2016 SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA LA UNIDAD DE CENTRO OBSTETRICO; NOTA**. Por motivo de cierre contable no se recibirá suministro y dará trámite a facturas y documentos de pago los últimos 3 días de cada mes. Además la entrega comprende, entregar acta y factura a la unidad financiera, para completar el proceso, caso contrario se tendrá por no entregado el servicio o producto que se traducirá en incumplimiento de entrega.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: **HOSPITAL NAC. SANTA GERTRUDIS**: Segunda Avenida Sur No. 23, Entre 4ta Y 8va. Calle Oriente, Barrio San Francisco, San Vicente, Teléfono: 2393-9500. **MINDISAL, S. A. de C. V.**: 1ª Calle Poniente # 3519, Colonia Escalón, San Salvador. Teléfonos: 2524-1600/1607, correos: info@mindisal.com.sv , ana.nerios@mindisal.com.sv

<p>_____</p> <p>Dra. Eva María Orellana Chacón Directora H. N. S. G.</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>

Elaborado por: aamejia

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS


Lugar y Fecha:	San Vicente 25 de Octubre del 2016	No.Orden:150/2016
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
MULTI INVERSIONES DIAZ SALVADOREÑAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FONDOS PROPIOS	-	-
1	Cada Uno	60303760 MONITOR MATERNO FETAL SENCILLO (Transductor de Frecuencia, Tocodinamometro y Transductor de Eventos). Ofrecen: MONITOR MATERNO FETAL SENCILLO. ESPECIFICACIONES: Monitor materno fetal, tipo portátil. Características: Visualización: pantalla de 10.4"del color TFT LCD, presenta onda y datos del monitor. Vigilar la forma de onda de FHR	\$1,962.03	\$1,962.03
TOTAL.....				\$1,962.03

SON: mil novecientos sesenta y dos 03/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: EN ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, DE 07:30 AM A 14:30 PM.

 Titular o Designado	
	
_____ Suministrante	

Elaborado por: aamejia