




MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"
SAN VICENTE



VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"

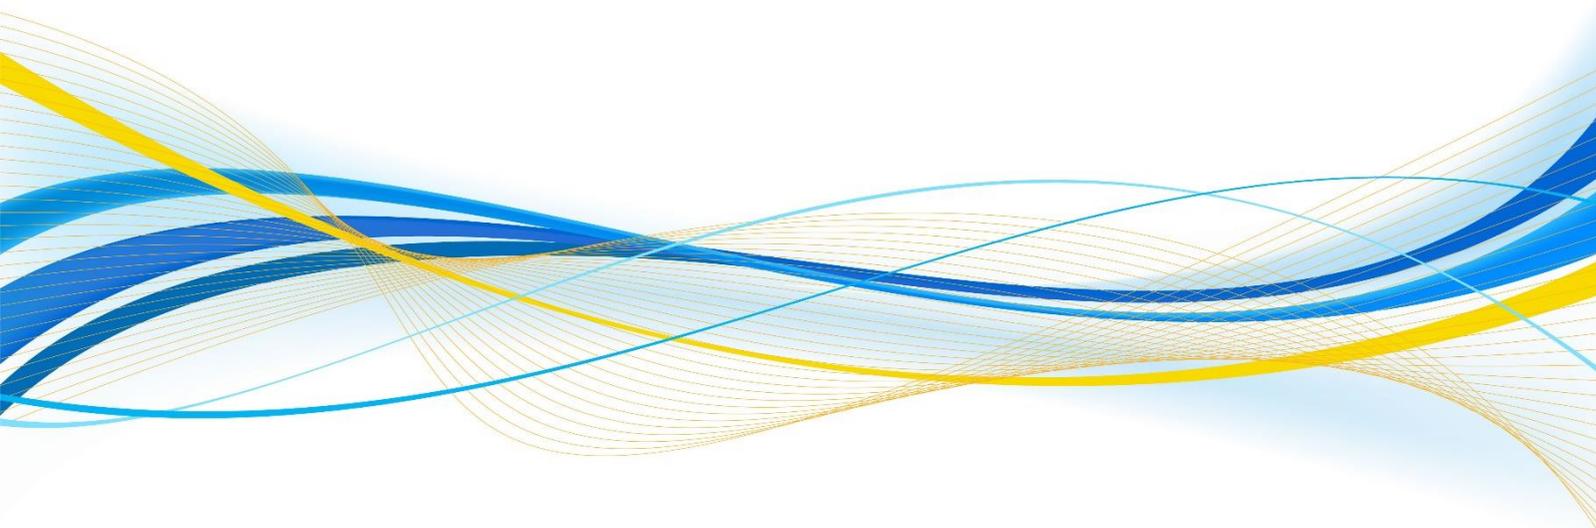

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de San Vicente

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN
NO:**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**Lugar y
Fecha:**San Vicente 16 de Julio del 2018**

No.Orden: 074/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**NIT****INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	FONDOS GOES	-	-
11	Cada Uno	<p>R-1; 81201055; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA. <u>SEGUN DETALLE SIGUIENTE</u>: a) 2 MANTENIMIENTOS A UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: OHIO; MODELO: UNITROL 2000; SERIE: ABD00115 (UBICADA EN SALA DE YESO DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA), MANTENIMIENTO PREVENTIVO; b) 2 MANTENIMIENTOS A UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIOS PLUS; SERIE: ARZF - 0086, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA. (UBICADA EN EL CENTRO OBSTETRICO), <u>DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA</u>: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERIVACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO; c) 2 MANTENIMIENTOS A UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIOS PLUS; SERIE: ARZF - 0087, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA. Y CAPNOGRAFO MARCA: DRAGER; MODELO: VAMOS. (UBICADA EN LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA), <u>DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA</u>: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERIVACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO. d) 2 MANTENIMIENTOS A UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIOS PLUS; SERIE: ARZF - 0088, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA. Y CAPNOGRAFO MARCA: DRAGER; MODELO: VAMOS. (UBICADA EN SALA No. 3 DEL CENTRO QUIRURGICO), <u>DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA</u>: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERIVACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO. e) 2 MANTENIMIENTOS A UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIOS PLUS; SERIE: ARZF - 0089, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA. (UBICADA EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA), <u>DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA</u>: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERIVACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO; Y f) 1 MANTENIMIENTO A VENTILADOR MECANICO DRAGER, OXILO.</p>	\$942.72727	\$10,370.00
		<p>OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA, <u>SEGUN DETALLE SIGUIENTE</u>: a) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: OHIO; MODELO: UNITROL 2000; SERIE: ABD00115 (UBICADA EN SALA DE YESO DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA). MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2 MANTTO. A \$ 150.00 = \$ 300.00</p>		

	<p>b) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIUS PLUS; SERIE: ARZF - 0086, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA. (UBICADA EN EL CENTRO OBSTETRICO). DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERIVACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO. 2 MANTTTO. A \$ 1,240.00 = \$ 2,480.00</p> <p>c) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIOSS PLUS; SERIE: ARZF - 0087, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA. Y CAPNOGRAFO MARCA: DRAGER; MODELO: VAMOS. (UBICADA EN LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULAROTIA). DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERIVACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO. 2 MANTTTO. A \$ 1,240.00 = \$ 2,480.00</p> <p>d) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIOS PLUS; SERIE: ARZF - 0088, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA. Y CAPNOGRAFO MARCA: DRAGER; MODELO: VAMOS. (UBICADA EN SALA No. 3 DEL CENTRO QUIRURGICO). DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERIVACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO. 2 MANTTTO. A \$ 1,240.00 = \$ 2,480.00</p> <p>e) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIOS PLUS; SERIE: ARZF - 0089, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA. (UBICADA EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA). DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERIVACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO. 2 MANTTTO. A \$ 1,240.00 = \$ 2,480.00</p> <p>f) VENTILADOR MECANICO DRAGER, OXILO. 1 MANTTTO. A \$ 150.00 = \$ 150.00</p>		
	NOTA: LINEA:0202 Atención Hospitalaria--	\$ 7,115.00	
	LINEA:0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer--	\$ 3,255.00	
-	-	TOTAL.....	\$10,370.00

SON: diez mil trescientos setenta 00/100 dolares

OBSERVACION: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA EN FECHA 26/06/2018; SERVICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, EL HOSPITAL DELEGA AL TECNÓLOGO EN ANESTESIA **MARCO ANTONIO AMAYA MAJIA, SUB JEFE DE ANESTESIOLOGÍA**, COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN PROCESO DE COMPRA No. **057/2018 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA, Fondos: GOES.** Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3 DIAS DE CADA MES; ADEMAS LA ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA, PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRARIO SE TENDRA POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.


LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL HOSPITAL ENTRE LA Y , DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, TELE/FAX: - ; E **INFRA DE EL SALVADOR, S. A. de C. V.**, EN , SAN SALVADOR; TEL: (503 - **Persona de Contacto:** ING. JUAN CARLOS CASTRO E ING. KATHERINE BEATRIZ AGUIRRE.

<hr/> Titular o Designado	<hr/>
<hr/>	<hr/> Suministrante

Elaborado por: rcornejo

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 16 de Julio del 2018		No.Orden:074/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FONDOS GOES	-	-
2	Cada Uno	R-1; 81201055; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA SEGUN DETALLE SIGUIENTE: b) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIUS PLUS; SERIE: ARZF - 0086, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA. (UBICADA EN EL CENTRO OBSTETRICO). DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERIVACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO. OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA, SEGUN DETALLE SIGUIENTE: b) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIUS PLUS; SERIE: ARZF - 0086, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA. (UBICADA EN EL CENTRO OBSTETRICO). DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERIVACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO.	\$1,240.00	\$2,480.00
2	Cada Uno	R-1; 81201055; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA SEGUN DETALLE SIGUIENTE: c) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIOSS PLUS; SERIE: ARZF - 0087, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA. Y CAPNOGRAFO MARCA: DRAGER; MODELO: VAMOS. (UBICADA EN LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA). DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERIVACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO. OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA, SEGUN DETALLE SIGUIENTE: c) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIOSS PLUS; SERIE: ARZF - 0087, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA. Y CAPNOGRAFO MARCA: DRAGER; MODELO: VAMOS. (UBICADA EN LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA). DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERIVACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO.	\$1,240.00	\$2,480.00

2	Cada Uno	R-1; 81201055; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA SEGUN DETALLE SIGUIENTE: e) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIOS PLUS; SERIE: ARZF - 0089, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA. (UBICADA EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA). DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERMACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO. OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA, SEGUN DETALLE SIGUIENTE: e) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIOS PLUS; SERIE: ARZF - 0089, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA. (UBICADA EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA). DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERMACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO.	\$1,240.00	\$2,480.00
		LINEA:0203 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer--FONDOS GOES		
2	Cada Uno	R-1; 81201055; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA SEGUN DETALLE SIGUIENTE: a) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: OHIO; MODELO: UNITROL 2000; SERIE: ABD00115 (UBICADA EN SALA DE YESO DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA). MANTENIMIENTO PREVENTIVO. OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA, SEGUN DETALLE SIGUIENTE: a) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: OHIO; MODELO: UNITROL 2000; SERIE: ABD00115 (UBICADA EN SALA DE YESO DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA). MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	\$150.00	\$300.00
2	Cada Uno	R-1; 81201055; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA SEGUN DETALLE SIGUIENTE: d) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIOS PLUS; SERIE: ARZF - 0088, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA Y CAPNOGRAFO MARCA: DRAGER; MODELO: VAMOS. (UBICADA EN SALA No. 3 DEL CENTRO QUIRURGICO). DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERMACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO. OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA, SEGUN DETALLE SIGUIENTE: d) UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DRAGER; MODELO: FABIOS PLUS; SERIE: ARZF - 0088, CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: DRAGER; MODELO: INFINITY VISTA Y CAPNOGRAFO MARCA: DRAGER; MODELO: VAMOS. (UBICADA EN SALA No. 3 DEL CENTRO QUIRURGICO). DEBERA INCLUIR EN LA PRIMERA VISITA: a) UN SENSOR SpO2 COMPLETO; b) UN CABLE ECG DE 3 DERMACIONES; c) UN CABLE MULTIMED; d) UN SENSOR DE FLUJO (Spirolog); e) 4 MANGAS NIBP (TALLAS: S, M, L, y XL) CON UNA MANGUERA NIMP; Y f) UNA BATERIA DE RESPALDO.	\$1,240.00	\$2,480.00
1	Cada Uno	R-1; 81201055; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA SEGUN DETALLE SIGUIENTE: f) VENTILADOR MECANICO DRAGER, OXILO. OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA. SEGUN DETALLE SIGUIENTE: f) VENTILADOR MECANICO DRAGER, OXILO.	\$150.00	\$150.00
		TOTAL.....		\$10,370.00

SON: diez mil trescientos setenta 00/100 dolares	
LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.	
	
 Titular o Designado	_____
_____	Suministrante

Elaborado por: rcornejo