




MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"  
SAN VICENTE




## VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"

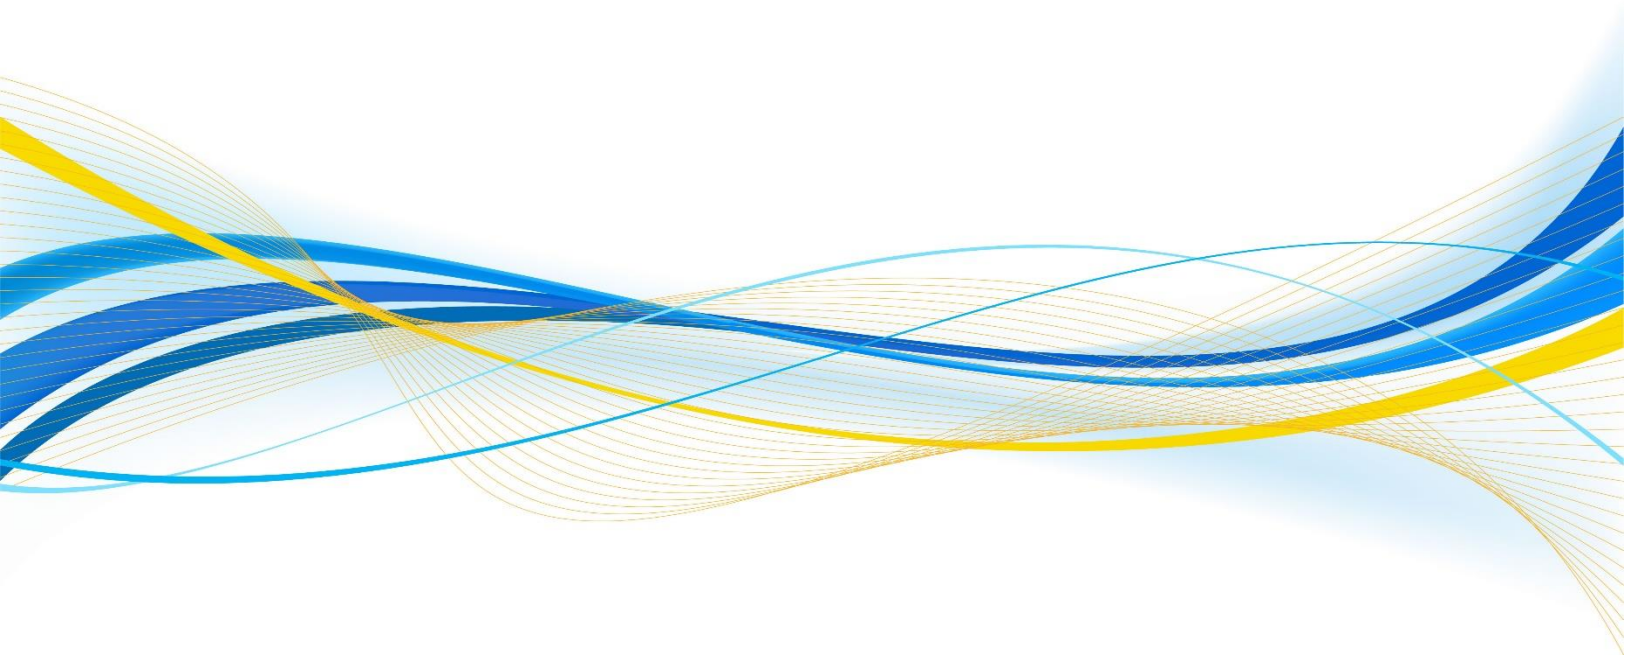

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		<b>San Vicente 31 de Enero del 2019</b>		<b>No.Orden:018/2019</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
8INFINITO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
3	Mantenimiento	<p><b>R-1; 81201104; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (GASES MEDICOS), <u>EL CUAL DEBERA EFECTUARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: a) UN MANIFOLD DE OXIGENO.</u> El cual requiere: Limpieza, Ajuste y prueba de cierre individual de la válvula Check, Colas de cerdo y tuercas de conexión, Prueba de fuga en cada banco y prueba a cada manómetro ya sea de alta o baja presión. <b>b) UN MANIFOLD DE OXIDO NITROSO.</b> El cual requiere: Limpieza, Reaprete y prueba de cierre individual de la válvula Check, Colas de cerdo y tuercas de conexión, Prueba de fuga en cada banco y prueba a cada manómetro ya sea de alta o baja presión. <b>c) UNA CENTRAL DE AIRE MEDICO.</b> El cual requiere Revisión de los Siguietes Componentes: Medición de Faja, Válvulas Solenoides, Manguera Flexible, Manómetros, Válvulas Electrónicas de Descarga, Pruebas de Fugas, Chequeo de PLC, Limpieza de Tarjetas Electrónicas, Limpieza General. <b>d) UNA CENTRAL DE VACIO MEDICO.</b> El cual requiere Revisión de los Siguietes Componentes: Manómetros, Válvulas Electrónicas de Descarga, Chequeo de PLC, Pruebas de Fuga, Válvulas Solenoide, Manguera Flexible, Limpieza General. <b>e) UNA ALARMA DE PRESION DE LINEA.</b> El cual requiere Revisión de los Siguietes Componentes: Tabletas de Control Digital, Prueba de Operación de Sensores, Limpieza de 13 Alarmas de Presión. y <b>f) UNA ALARMA MAESTRA.</b> El cual requiere Revisión de los Siguietes Componentes: Tabletas de Control Digital, Prueba de Funcionamiento de 3 Alarmas Maestras, Limpieza. <b>OFRECEN:</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (NO INCLUYE REPUESTOS) PARA EQUIPO MEDICO (GASES MEDICOS), CADA 4 MESES PARA EL AÑO 2019. <u>EL CUAL SE EFECTUARA DE LA SIGUIENTE MANERA: a) UN MANIFOLD DE OXIGENO.</u> SERVICIO A EFECTUAR: LIMPIEZA, AJUSTE Y PRUEBA DE CIERRE INDIVIDUAL DE LA VÁLVULA CHECK, COLAS DE CERDO Y TUERCAS DE CONEXIÓN, PRUEBA DE FUGA EN CADA BANCO Y PRUEBA A CADA MANOMETRO YA SEA DE ALTA O BAJA PRESION. <b>b) UN MANIFOLD DE OXIDO NITROSO.</b> SERVICIO A EFECTUAR: LIMPIEZA, REAPRETE Y PRUEBA DE CIERRE INDIVIDUAL DE LA VALVULA CHECK, COLAS DE CERDO Y TUERCAS DE CONEXION, PRUEBA DE FUGA EN CADA BANCO Y PRUEBA A CADA MANOMETRO YA SEA DE ALTA O BAJA PRESION. <b>c) UNA CENTRAL DE AIRE MEDICO.</b> SERVICIO A EFECTUAR: REVISION DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: MEDICION DE FAJA, VALVULAS SOLENOIDES, MANGUERA FLEXIBLE, MANOMETROS, VALVULAS ELECTRONICAS DE, DESCARGA, PRUEBAS DE FUGAS, CHEQUEO DE PLC, LIMPIEZA DE TARJEJAS ELECTRONICAS,LIMPIEZA GENERAL. <b>d) UNA CENTRAL DE VACIO MEDICO.</b> SERVICIO A EFECTUAR: REVISION DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: MANOMETROS, VALVULAS ELECTRONICAS DE DESCARGA, CHEQUEO DE PLC, PRUEBAS DE FUGA, VALVULAS SOLENOIDE, MANGUERA FLEXIBLE, LIMPIEZA GENERAL. <b>e) UNA ALARMA DE PRESION DE LINEA.</b> SERVICIO A EFECTUAR: REVISION DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: TABLETAS DE CONTROL DIGITAL, PRUEBA DE OPERACION DE SENSORES, LIMPIEZA DE 13 ALARMAS DE PRESION. y <b>f) UNA ALARMA MAESTRA.</b> SERVICIO A EFECTUAR: REVISION DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: TABLETAS DE CONTROL DIGITAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE 3 ALARMAS MAESTRAS, LIMPIEZA. <b>NOTA:</b> SI EL EQUIPO REQUIERE UN REPUESTO POR FALLAS 8INFINITO, S. A. de C. V. LO DETALLARA EN EL REPORTE DE MANTENIMIENTO Y POSTERIORMETE PRESENTARA LA COTIZACION DEL MISMO. SERA EL HNSGSV EL ENCARGADO DE GESTIONAR LA COMPRA DEL REPUESTO; <b>Además:</b> Para Mantener los precios Ofertados. Solicitamos que el HNSGSV no Disminuya la Cantidades por ITEM y Adjudique la Totalidad de ITEMS de la Presente Cotización. <b>MARCA:</b> No lo Especifica; <b>ORIGEN:</b> No lo Especifica; <b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> de Inmediato y según Programación, después de Recibida la Orden de Compra debidamente Legalizada; <b>GARANTIA:</b> Por defectos de Fabricación, por un periodo de 2 meses, No Incluye: Mal uso, ni Fenómenos Naturales, Malas Condiciones de Almacenaje, ni caso Fortuito, ni Fallas de la Red Eléctrica del Hospital, ni la Reparación por Personal Ajeno a nuestra Empresa, durante el periodo de Contrato.</b></p>	\$895.00	\$2,685.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,685.00

SON: dos mil seiscientos ochenta y cinco 00/100 dólares

**OBSERVACION:** SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA EN FECHA 14/01/2019; SERVICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, EL HOSPITAL DELEGA AL SEÑOR **JOSE ANTONIO HERNANDEZ MEJIA, TECNICO EN MANTENIMIENTO II**, COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y SERA LA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN PROCESO DE COMPRA **No. 011/2019 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (GASES MEDICOS)**. Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3 DIAS DE CADA MES; ADEMÁS LA ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA, PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRARIO SE TENDRÁ POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA.

**LUGAR DE ENTREGA:** EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

**LUGAR DE NOTIFICACIONES:** EL HOSPITAL ENTRE LA \_\_\_\_\_, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE \_\_\_\_\_, TELE/FAX: - - ; Y **8INFINITO, S. A. de C. V.**, EN \_\_\_\_\_, TEL ( ): - - , CEL ( ): - - ; **Persona de Contacto:** ARQ. DOLORES ULISES ECHEVERRIA SIBRIAN.

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por: rcornejo



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de San Vicente

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Vicente 31 de Enero del 2019

No.Orden:018/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

8INFINITO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
3	Mantenimiento	R-1; 81201104; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (GASES MEDICOS), EL CUAL DEBERA EFECTUARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: a) UN MANIFOLD DE OXIGENO. El cual requiere: Limpieza, Ajuste y prueba de cierre individual de la válvula Check, Colas de cerdo y tuercas de conexión, Prueba de fuga en cada banco y prueba a cada manómetro ya sea de alta o baja presión. b) UN MANIFOLD DE OXIDO NITROSO. El cual requiere: Limpieza, Reaprete y prueba de cierre individual de la válvula Check, Colas de cerdo y tuercas de conexión, Prueba de fuga en cada banco y prueba a cada manómetro ya sea de alta o baja presión. c) UNA CENTRAL DE AIRE MEDICO. El cual requiere Revisión de los Sigüientes Componentes: Medición de Faja, Válvulas Solenoides, Manguera Flexible, Manómetros, Válvulas Electrónicas de Descarga, Pruebas de Fugas, Chequeo de PLC, Limpieza de Tarjetas Electrónicas, Limpieza General. d) UNA CENTRAL DE VACIO MEDICO. El cual requiere Revisión de los Sigüientes Componentes: Manómetros, Válvulas Electrónicas de Descarga, Chequeo de PLC, Pruebas de Fuga, Válvulas Solenoide, Manguera Flexible, Limpieza General. e) UNA ALARMA DE PRESION DE LINEA. El cual requiere Revisión de los Sigüientes Componentes: Tabletas de Control Digital, Prueba de Operación de Sensores, Limpieza de 13 Alarmas de Presión. y f) UNA ALARMA MAESTRA. El cual requiere Revisión de los Sigüientes Componentes: Tabletas de Control Digital, Prueba de Funcionamiento de 3 Alarmas Maestras, Limpieza. OFRECEN: SERVICI	\$895.00	\$2,685.00
TOTAL.....			-	\$2,685.00

SON: dos mil seiscientos ochenta y cinco 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

  
  
 Titular o Designado

<hr/>	<hr/> <p>Suministrante</p>
-------	----------------------------

*Elaborado por: rcornejo*